SECCION DE REFERENCIA

OLYMPUS EndoTherapy

Conexión de la camisa al Mango LithoCrushV (MAJ-441) 86

Uso de los Balones de Dilatación MaxPass (Serie B-400N) 87-88

Centros de Entrenamiento 88

OLYMPUS®

Como conectar la camisa al Mango LithoCrushV (MAJ-441)

1 Gire la tuerca de fijación en sentido contrario a las manecillas de reloj. Luego, desactive el trinquete (manecilla negra en posición OFF) y empuje la perilla de manipulación hasta que haga contacto con el cuerpo principal y quede fija.

2 Hale el vástago proximal de la canastilla hasta que la marca negra quede visible. Luego, sujete el vástago e introdúzcalo por el orificio de inserción del cuerpo principal del mango hasta que se detenga, sonará un clic.

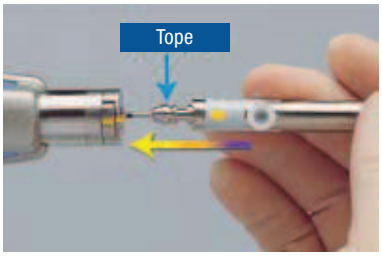

3 Empuje el extremo del vástago hacia el orificio de inserción en el mango hasta que este se detenga alineando la flecha amarilla de la camisa con la marca amarilla del mango. Ajustar y confirmar con otro clic.

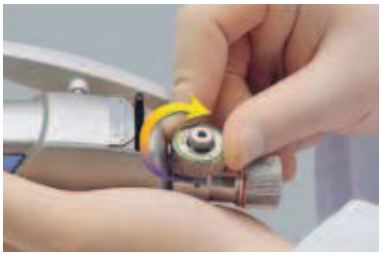

4 Gire la tuerca de fijación del mango en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar el vástago.

Instrucciones para el Uso de los Balones de Dilatación MaxPass (Serie B-400N)

Los Balones para Dilatación MaxPass están diseñados para dilatar estenosis a nivel del sistema biliar y la papila.

Advertencia: Esta guía es únicamente un resumen del manual de instrucciones del producto B-400N-MaxPass. Por favor asegúrese leer el manual de instrucciones que esta incluido en la caja cuando compró el producto

Preparación antes de uso:

1

Llene el insuflador con medio de contraste hasta la mitad (10ml). Asegúrese que el letrero OFF de la perilla de la llave de paso apunte a las 3pm.

2

Remueva el aire del insuflador. Este proceso es similar a remover el aire de una jeringa.

- Voltee el insuflador –con el medidor de presión hacia arriba- de tal forma que el aire aspirado vaya hacia la parte de arriba del insuflador. (Ver imagen)
- Empuje el émbolo hasta que un chorro continuo de medio de contraste salga por la llave de paso.

3

Remueva el aire del balón. (Parte uno)

- Conecte el catéter balón a la llave de paso y voltee el insuflador hacia abajo (sujetador hacia arriba).
- Hale el émbolo y asegúrelo.

4

Remueva el aire del balón. (Parte dos)

- Voltee el insuflador (con el medidor de presión hacia arriba) de tal forma que el aire aspirado vaya hacia la parte de arriba del insuflador.
- Gire la perilla de la llave de paso de tal forma que apunte hacia las 12pm. En este momento se escuchará el aire saliendo. (Ver imagen).

5

Empuje el émbolo para remover el aire que todavía esta presente. Continúe empujando hasta que un chorro continuo de medio de constante salga por la llave de paso.

6

Gire la perilla de seguridad de la llave de paso de tal forma que esta vuelva apuntar a las 3pm. Ahora el balón de dilatación MaxPass esta listo para ser utilizado.

Inflado y desinflado del Balón de Dilatación MaxPass en la siguiente página.

Instrucciones para el Uso de los Balones de Dilatación MaxPass (Serie B-400N)

Los Balones para Dilatación MaxPass están diseñados para dilatar estenosis a nivel del sistema biliar y la papila.

Advertencia: Esta guía es únicamente un resumen del manual de instrucciones del producto B-400N-MaxPass. Por favor asegúrese leer el manual de instrucciones que esta incluido en la caja cuando compró el producto

Para INFLAR el Balón de Dilatación MaxPass:

7 Sujete el insuflador de tal forma que el seguro apunte hacia arriba.

8

Empuje el émbolo lo más que pueda. Asegúrelo rotando el seguro hacia la izquierda.

9 Gire el émbolo en el sentido de las manecillas de reloj hasta que obtenga la presión deseada (atm). La presión máxima del MaxPass es de 12 atm.

Para DESINFLAR el Balón de Dilatación MaxPass:

10

Quite el seguro (rotando hacia la derecha) y hale el émbolo.

11 Asegure nuevamente el émbolo una vez este se encuentre totalmente afuera.